


بر اساس تحقیقات سال ۱۴۰۱

مدت زمان تعویض فیلتر دستگاه گازسنج در عسلویه بر اساس داده‌های گزارش شده از سایت هواشناسی و سامانه پایش کیفی هوای کشور

عسلویه	دما	رطوبت	میانگین شاخص کیفیت هوا	W(h)	W(AQI)	W(T)	filter replacement time
فروردین	22.9419	76.1106	133.567	After Each Use			
اردیبهشت	26.9393	61.2277	169.633	2	0	2	25 DAYS
خرداد	30.65	64.2863	143.333	1	1	2	25 DAYS
تیر	31.4267	61.7708	130.933	1	1	2	25 DAYS
مرداد	39.3129	50.8266	126.367	1	1	2	25 DAYS
شهریور	41.5033	57.6589	124.767	-1	1	0	15 DAYS
مهر	42.1387	65.6452	116.867	-2	1	-1	10 DAYS
آبان	42.6065	63.6838	107.167	-2	1	-1	10 DAYS
آذر	40.39	67.975	106.667	-1	1	0	15 DAYS
دی	37.0677	67.7442	128.733	0	1	1	15 DAYS
بهمن	32.79	60.3833	125.067	0	1	1	15 DAYS
اسفند	27.1226	61.4741	131.267	2	1	3	25 DAYS

FOR T>35 AND/OR RH%>40 CHANGE THE FILTER IMMEDIATELY IN HEAVY INDUSTRY SITUATION

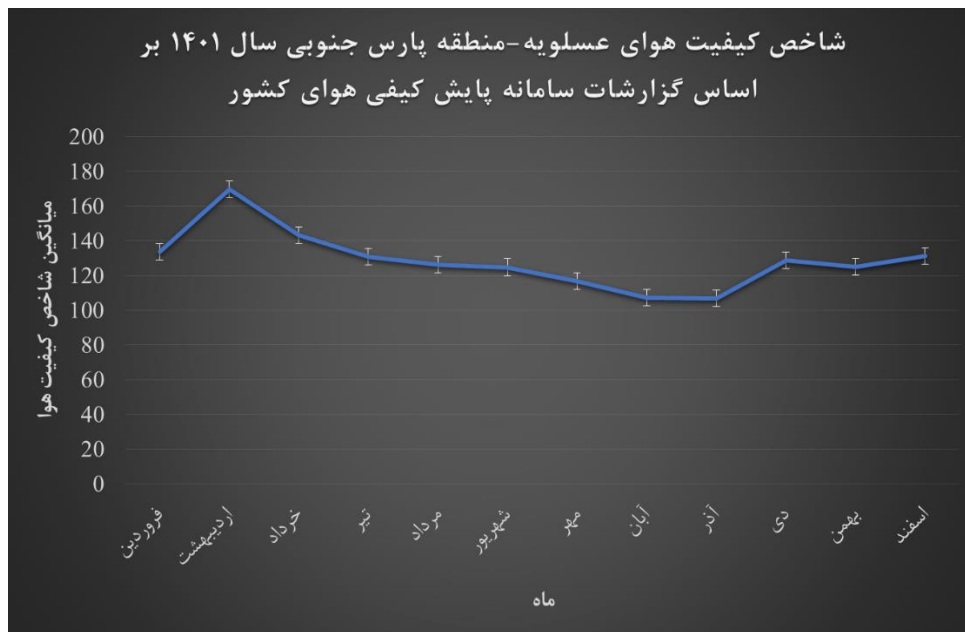

بررسی اثر دما و رطوبت در شرایط heavy industry dust و زمان تعویض فیلترها

T (°c) ≥ 35	RH (%) ≥ 40	Filter replacement time (day)
✓	×	Change the filters Immediately
×	✓	
✓	✓	
×	×	6-8 days